



<u>Première de montage</u>	
Gauche	
Première de montage	
Standard	~
Renfort première de montage	
Sans renfort	~
Cambrion	
Plastique	~
Droite	
Première de montage	
Standard	~
Renfort première de montage	
Sans renfort	~
Cambrion	
Plastique	~
Première d'amplitude Gauche	
Matériel	
Liège	
Droite	
Matériel	
Liège	~
À l'avant-pied	
0	
mm	
Tout le long	
6	
mm	
observations	
2X3MM	

À l'avant-pied	
0	
mm	
Tout le long	
6	
mm	
observations	
2X3MM	
<u>Contrefort</u>	
Gauche	
Туре	
Normal (1001) Normal	~
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	~
Droite	
Туре	
Normal (1001) Normal	~
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	~
Hauteur de Tige (~ 14 5cm)	Tour de Jambe


<u>Hauteur de Tige (≈ 14.5cm)</u>	Tour de Jambe		
Gauche	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
14,5	0	Sélection 🗸	0
cm Droite	0	Sélection 🗸	0
14,5	0	Sélection 🗸	0
cm Avec orthèse	0	Sélection 🗸	0
	0	Sélection 🗸	0
	0	Sélection 🗸	0
	0	Sélection 🗸	0
	0	Sélection 🗸	0
	0	Sélection 🗸	0



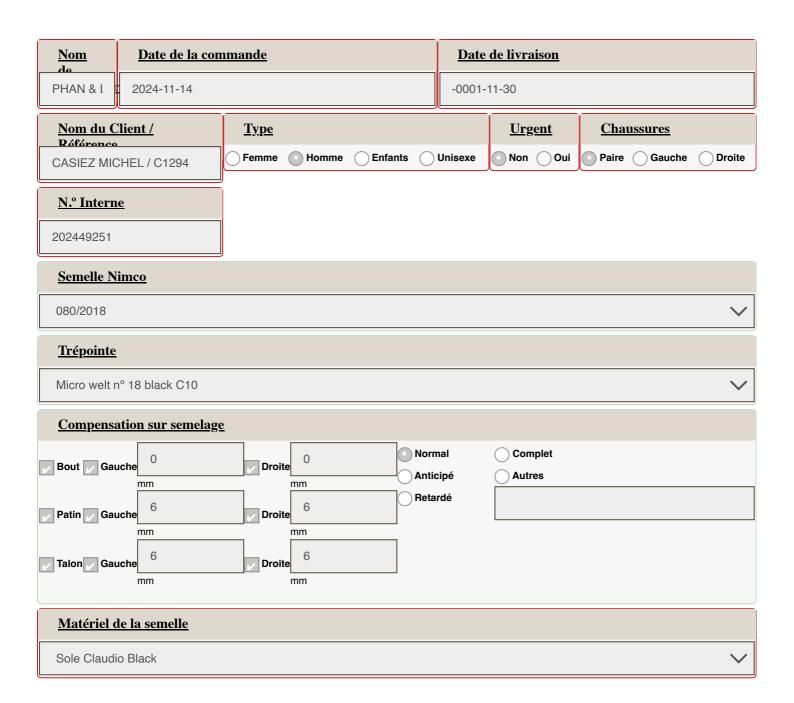

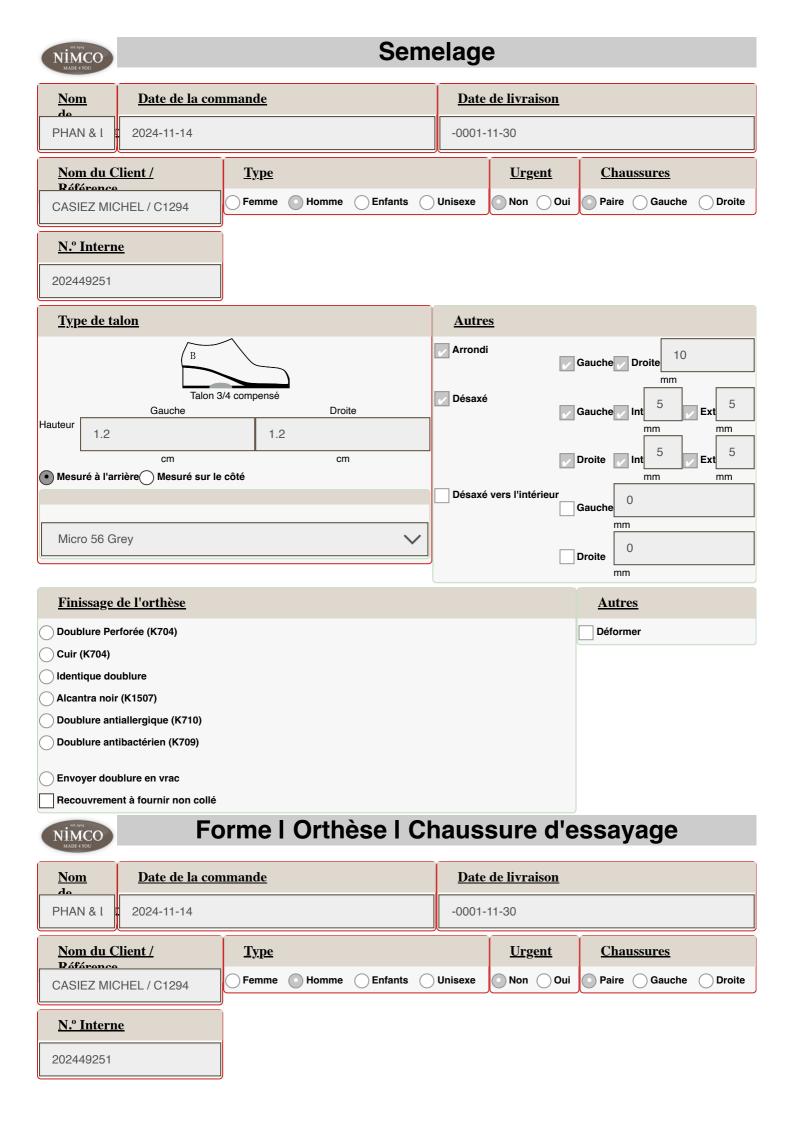


<u>Option de f</u>	<u>Cormes</u>				
Forme existan	te				
Nouvelle Form	ne/Orthèse				
<u>Forme</u>			<u>Dessin du bout</u>		
Moule en plâtre Empreinte sur papier Digitalisation du pied Empreinte sur mousse Forme en	Gauche	Droite		sintu Rond	Rond et Large
Polyuréthane			Découpe de la fo	<u>rme</u> 	
Forme en bois Juste fraiser	Gauche Normal Droite Normal	Dur Dur	Type 1Ty	pe 2	2
Hauteur de la forme	e 0 cm	0	cm		
Hauteur du talon Relevé du bout	0 cm		om om		
Épaisseur du bout	0 cm	0	cm		
	1.6				
Mesures de	<u>e la forme</u>	н	AUTEUR		1
0	4	Gauche	Droite	4.	
2	3	0 0	0	3	2
0	2 ^{2a}	0 0	0	2 ^{2a})
2a		0 0	0		2a
0	1			1 (
3		0 0	0		3
0 4		0 0	0		4
0			,		
5					5
0				C)
<u>Orthèse</u>					
	Multiforme + Liège Micro cork Multiforme Autre	Physic Métartars Ta	GaucheDroite logik (4/4/4)		

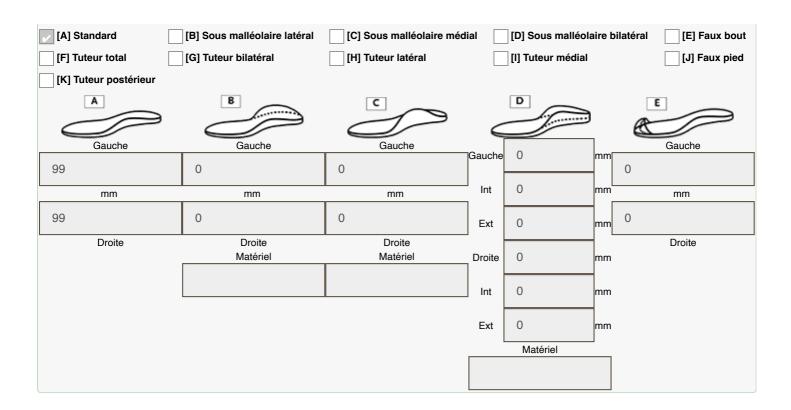



Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

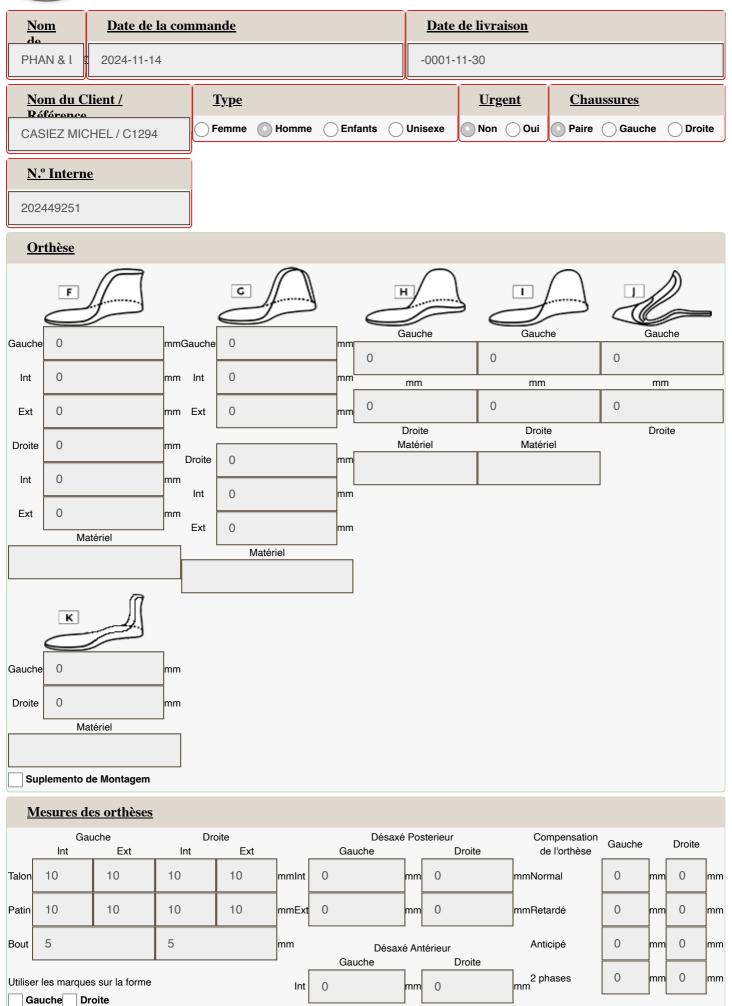

		Ext	0	nm 0	mmCon	nplet 0 mm	0 mm
A l'aplomb de la malléole			Mo	Mousse de capitonnage			
Int Ext	Gauche	Droite	À l'avant- Au talon Dans le r Complet		Épaisseur	Int GaucheDroite Gauche Gauche Smm 5mm	
Chaussure	d'essayage						
Hauteur Gauche Hauteur Gauche du talon Plastique dur Plastique sou	0 mmDroite	0 mm Gauche	Talon (Patin (Bout (Gauche))	mm 0 mm mm 0 mm	Complet (e et la couche mm mm
Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage							
Nom	Date de la com	mande		<u>Date</u>	de livraison		
PHAN & I	2024-11-14			-0001-	11-30		
Nom du C	lient /	<u>Type</u>			<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>	
CASIEZ MIC	HEL / C1294	Femme Homme	Enfants	Jnisexe	Non Oui	Paire Gauche	Droite
N.º Interne							